


ovesco training campus
TÜBINGEN
CARY
PARIS
CHENNAI


OTSC®neo System – Notice de montage

Diamètre de l'endoscope			
OTSC®neo mini	OTSC®neo 11	OTSC®neo 12	OTSC®neo 14
8,5 – 10 mm	8,5 – 11 mm	10,5 – 12 mm	11,5 – 14 mm


Vidéo de montage

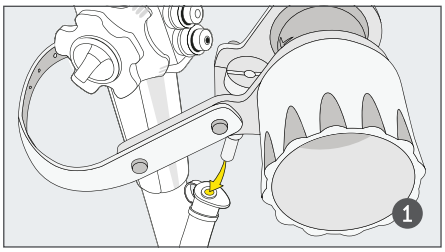


Monter la manivelle sur le canal opérateur de l'endoscope.

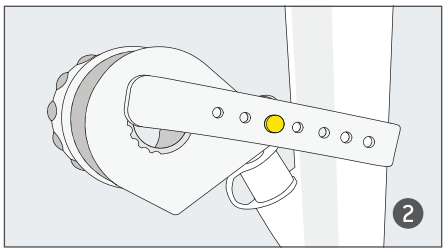


Fermer la bande de fixation de la manivelle dans le trou correspondant.

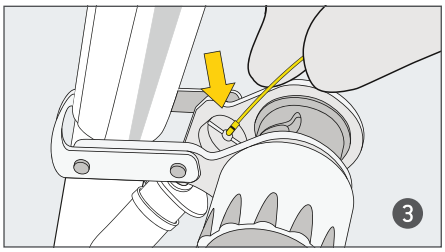


Insérez l'attrape-fil dans le canal opérateur.

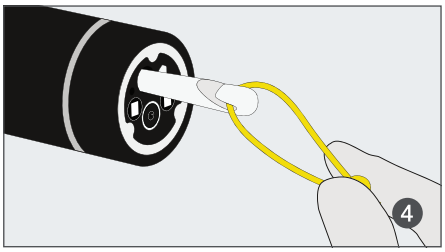


Saisir l'extrémité du fil avec l'attrape-fil. Tirer le fil à travers le canal opérateur.

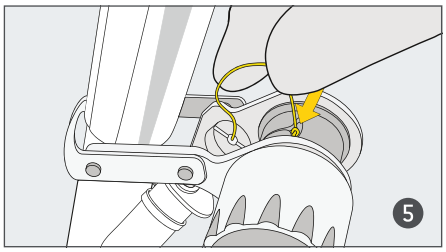


Serrer le fil dans la rainure de la manivelle.

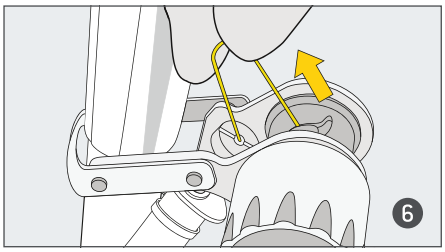


Tenir le fil et tirer.

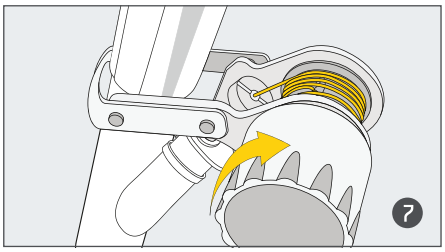


Enrouler le fil avec la manivelle.

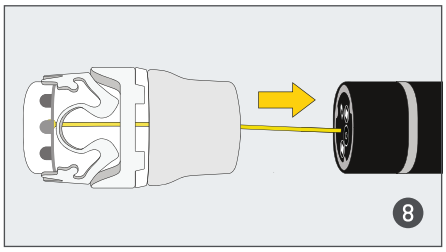


Placer le capuchon sur l'endoscope.

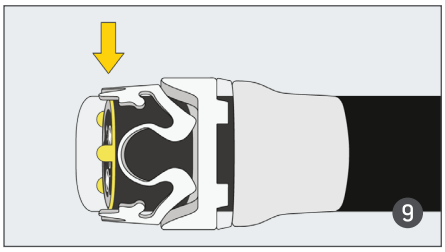


Avancer l'endoscope jusqu'aux butées dans le capuchon.
Outils : liquides, p.ex. gel.

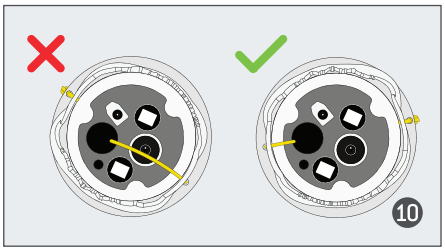

Tenir compte de la position du fil lord de la fixation du capuchon sur l'endoscope. Le fil ne doit pas gêner le champ de vision.

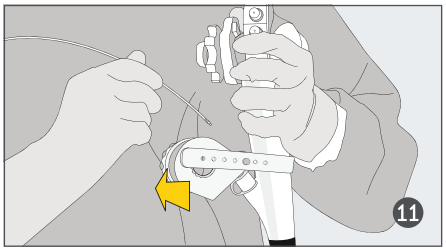

Si un autre instrument est inséré dans le canal opérateur, le fil doit être légèrement tendu.

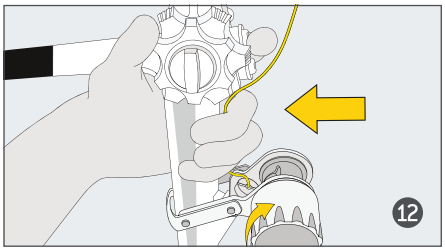

Avant l'application du clip, l'instrument doit être tenu fermement. Pout libérer le clip, la manivelle doit être tournée rapidement et complètement.

OVE_OTSCneo-System_infosheet-assembly_fra_Rev02